

Tympanoplastikkproteser

Totalproteser, variabel lengde

Tilbehør



TTP VARIAC System Total



HEINZ KURZ GMBH
TUEBINGER STR. 3
72144 DUSSLINGEN
GERMANY

Innholdsfortegnelse

1 Om dette dokumentet	3
1.1 Symbolordliste	3
1.2 Merking med sikkerhetsinformasjon	3
1.3 Tilleggsinformasjon	4
1.4 Sikkerhetsrelaterte endringer	4
2 Viktig sikkerhetsinformasjon	4
3 Artikkelnumre / REF	4
4 Leveringsomfang	4
5 Emballasje og sterilitet	5
6 Produktbeskrivelse	5
6.1 Generell informasjon	5
6.2 Struktur og bruk	5
6.3 Materialer med potensiell pasientkontakt	5
6.4 Tilbehør	5
6.5 Andre enheter som skal brukes i kombinasjon med enheten	6
7 Tiltent bruk	6
7.1 Tiltent bruk	6
7.2 Indikasjoner	6
7.3 Kontraindikasjoner	7
7.4 Pasientmålgruppe	7
7.5 Tiltent bruker	7
7.6 Forventet levetid	7
7.7 Tiltent brukssted	7

8 Forventet klinisk nytte	7
9 Mulige komplikasjoner og bivirkninger	7
10 Kombinasjon med andre prosedyrer	7
11 Oppbevaringstid og lagring	8
12 Prosessering	8
13 Bruksinstruksjoner	8
13.1 Nødvendig utstyr og materialer	8
13.2 Forberedelse av pasienten	9
13.3 Bestemme proteselengden	9
13.4 Pakke ut protesen	9
13.5 Justere lengden på protesen	10
13.6 Plassering av protesen	11
13.6.1 Plassering av protesen på stigbøylens fotplate	11
13.6.2 Koble hodeplaten til trommehinnen / malleushåndtaket	11
13.6.3 Kontroller protesens passform	12
13.7 Fjerning av protesen	12
14 Etterbehandling	12
15 Instruksjoner til pasienten	12
16 Implantatkort	12
17 Avfallshåndtering	12
18 Garanti	12
19 Spesifikasjoner	13

1 Om dette dokumentet

1.1 Symbolordliste

Symbol	Beskrivelse
	Forsiktig: Sjekk bruksanvisningen
	Forsiktig!
	Kan knuses; må behandles varsomt
	Må ikke brukes dersom emballasjen er skadet
	Må ikke utsettes for direkte sollys
	Må holdes tørt
	Utløpsdato
	Sterilisert gjennom bestråling
	Må ikke gjenbrukes
	Må ikke resteriliseres
	Enkelt sterilt barriersystem
	Enkelt sterilt barriersystem med beskyttelsesemballasje på innsiden
	Enkelt sterilt barriersystem med beskyttelsesemballasje på utsiden
	MR-betinget
	Medisinsk utstyr
	Artikkelnummer
	Partikode
	Unik enhets-ID (UDI)
	Antall per pakkeenhet
	Produsent
	Produksjonsdato
	(USA) forsiktig: Ifølge amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges av eller etter rekvisisjon fra lege.
	Sjekk bruksanvisningen. Bruksanvisningen formidles i elektronisk form (e-merking).
	Pasientnavn
	Implantasjonsdato
	Navn på helseinstitusjon / helseleverandør som utførte implantasjon
	Nettside for pasientinformasjon

Tabell 1: Symbolordliste

1.2 Merking med sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

Manglende overholdelse kan føre til alvorlige personskader, alvorlig forverring av den generelle tilstanden eller dødsfall hos pasienten, brukeren eller en tredjepart.

MERKNAD

Produktskade eller annen skade kan oppstå ved manglende overholdelse.

1.3 Tilleggsinformasjon

Dette dokumentet er tilgjengelig i elektronisk form på produsentens nettsted. Om nødvendig kan en trykt kopi av dette dokumentet forespørres fra produsenten.

Lenke for nedlasting av denne bruksanvisningen: ¹⁾	www.kurzmed.com/en/ifu/tym4.html
Lenke for nedlasting for prosesseringsinstruksjoner: ¹⁾	https://www.kurzmed.com/en/ifu/reprocessing.html
 Lenke for nedlasting av pasientinformasjonsarket: ¹⁾	www.kurzmed.com/en/pi/tym.html
Ansvarsfraskrivelse for tilgjengeligheten av SSCP	Generell regel: SSCP gjøres kun tilgjengelig etter at produktet er autorisert i henhold til EU-DIREKTIVET 2017/745 (MDR). Implementeringen som beskrives her gjelder ikke før den korresponderende modulen i Eudamed-databasen trer i kraft. Inntil det er SSCP tilgjengelig fra følgende nedlastingslenke: www.kurzmed.com/en/sscp/tym.html
Sammendrag av sikkerhet og klinisk ytelse (SSCP): ¹⁾	https://ec.europa.eu/tools/eudamed For å søke etter produktspesifikk SSCP angi grunnleggende UDI-DI for produktet.
Grunnleggende UDI-DI (enhets-ID):	++EHKM0017D
Internasjonale adresser:	https://www.kurzmed.com/en/contact.html

¹⁾ Oppdateres kontinuerlig. Andre språkversjoner er også tilgjengelig der.

For komplett UDI (UDI-PI), se produktetiketten.

1.4 Sikkerhetsrelaterte endringer

Dokumentnummer	Utgavedato	Sikkerhetsrelaterte endringer
0005955_01	2024-10	Fullstendig revisjon
0005955_02	2026-02	Ingen

2 Viktig sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL

- Les bruksanvisningen før produktet benyttes. Følg og ta vare på bruksanvisningen. Ellers foreligger det en helserisiko for pasienten din.
- Du må ikke demontere eller endre produktet. Ellers foreligger det en helserisiko for pasienten din.

OBS: Dersom det oppstår en alvorlig hendelse forbundet med enheten, bør hendelsen rapporteres til produsenten og ansvarlig myndighet i regionen hvor brukeren og / eller pasienten befinner seg.

3 Artikkelnumre / REF

[► Spesifikasjoner, side 13]

4 Leveringsomfang


TTP VARIAC System Total (Tympanoplastikkprotese + AC Sizer System Total)	1 x tympanoplastikkprotese 1 x Størrelsesdisk 1 x implantatkort 4 x produktetikett
Tilbehør: Titanpinsett / Mikrosaks / Kuttetang / Mikrolukketang i titan/ Instrumentbrett (Tray TTP VARIAC)	1 x instrument / instrumentbrett (Tray TTP VARIAC) 1 x prosesseringsinstruksjoner

5 Emballasje og sterilitet

TTP VARIAC System Total (Tympanoplastikkprotese + AC Sizer System Total)	Produktet er sterilt (sterilisert med stråling). Emballasje: Enkelt sterilt barriersystem med beskyttelsesemballasje inni (protese i trekantet plastboks og hard blister) + ytteremballasje (sammenleggbar boks)
Tilbehør: Titanpinsett/Mikrosaks/Kuttetang/ Mikrolukketang i titan/ Instrumentbrett (Tray TTP VARIAC)	Produktet er ikke sterilt. Emballasje: Pose med glidelås + ytteremballasje (sammenleggbar eske); Instrumentbrett: Kun poser med smekklås

6 Produktbeskrivelse

6.1 Generell informasjon

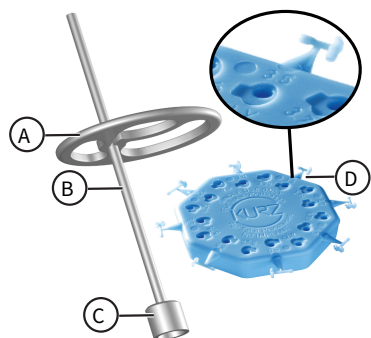

- A Fenestrert hodeplate med låsemekanisme
- B Skaft med variabel lengde
- C Fot: Stempel, hul
- D Avtakbare målere i forskjellige lengder, med størrelsesangivelse
Fordypninger for å forkorte protesen til den bestemte lengden

Illustrasjon 1: Tympanoplastikkprotese, AC-målersystem totalt (målerskive)

[▶ Spesifikasjoner, side 13]

Tilbehør: [▶ Tilbehør, side 5]

6.2 Struktur og bruk

Tympanoplastikkprotese	Proteser som settes inn for å delvis eller fullstendig erstatte mellomørestrukturer involvert i lydledning.
AC Sizer System Total	Sett med avtakbare dummyproteser montert på en skive, der hver er tilsvarende i størrelse til en av de tilgjengelige tympanoplastikkprotesene. Dummyprotesene brukes til å bestemme størrelsen på den nødvendige tympanoplastikkprotesen. Skiven brukes til å justere lengden på KURZ TTP VARIAC del- / totale proteser før innsetting.

6.3 Materialer med potensiell pasientkontakt

Tabellen nedenfor viser alle implantatmaterialer som brukeren eller pasienten kan komme i kontakt med under påføring.

Produkt (del)	Materiale	Kontaktperson
Tympanoplastikkprotese	100 % titan	Pasient

AC Sizer System Total: [▶ Spesifikasjoner, side 13]

Er ikke fremstilt med naturgummi (lateks).

Ingen produkter fremstilt med naturgummi (lateks) benyttes under produksjonsprosessen.

OBS: Ikke bruk produktet dersom pasienten har dokumentert intoleranse / allergi mot benyttede materialer.

6.4 Tilbehør

Systemtilbehør for TTP VARIAC System Total:

Tilbehør	Figur	REF	Materiale	Tiltenkt bruk
Titanpinsett		8000136	Titan	Titanpinsettene er en passiv, gjenbrukbar enhet som brukes intraoperativt og ikke-invasivt under en tympanoplastikkprosedyre for å håndtere KURZ tympanoplastikkproteser.

Tilbehør	Figur	REF	Materiale	Tiltenkt bruk
Mikrosaks		8000172	Rustfritt stål	Mikrosaksen er en passiv, gjenbrukbar enhet som brukes intraoperativt og ikke-invasivt for å kutte måleren fra AC-størrelsessystemet, helt / delvis.
Mikrolukketang i titan		8000137	Titan	Mikrolukketang i titan er en passiv, gjenbrukbar enhet som brukes intraoperativt og ikke-invasivt for å feste hodeplaten til en KURZ TTP VARIAC-protese til skaftet, etter at lengden er justert.
Kuttetang		8000171	Rustfritt stål	Kuttetangen er en passiv, gjenbrukbar enhet som brukes intraoperativt og ikke-invasivt for å kutte av den utstikkende delen av skaftet til en KURZ TTP VARIAC-protese etter at lengden er justert og hodeplaten er fiksert.
Instrumentbrett (Tray TTP VARIAC)		8000173	Rustfritt stål	Brett TTP VARIAC-settet er en gjenbrukbar enhet som brukes til å holde KURZ VARIAC-settets instrumenter under transport, sterilisering og lagring.

Annet tilbehør (separat bruksanvisning):

- KURZ Precise Bruskknivsett (REF 8000 155)
- Bruskstansesett (REF 8000 200)
- Brusk tang Schimanski Design (REF 8000 193)

6.5 Andre enheter som skal brukes i kombinasjon med enheten

Tympanoplastikkproteser er compatible med følgende KURZ-produkt: OMEGA CONNECTOR (separate instruksjoner for bruk) Bortsett fra disse, og med unntak av utstyr og materialer som kreves for implantasjon, er produktet ikke beregnet for bruk sammen med andre produkter.

7 Tiltenkt bruk

7.1 Tiltenkt bruk

Tympanoplastikkprotese	KURZ mellomøreproteser er beregnet for delvis eller total kirurgisk utskifting av ossikkelkjeden i det menneskelige mellomøre. Målet er å gjenopprette den mekaniske overføringen av lyd fra trommehinnen til det ovale vinduet i cochlea med minst mulig hørselshemming.
AC Sizer System Total	AC Sizer System Total er en passiv, steril engangsenhet. Måleren brukes til intraoperativ og kirurgisk invasiv bestemmelse av lengden på KURZ tympanoplastikk-totalproteser ved å midlertidig sette måleren inn i implantatstedet. AC Sizer System Total brukes til ikke-invasiv justering av KURZ TTP VARIAC System Total-proteser før implantasjon.

Tilbehør: [► Tilbehør, side 5]

7.2 Indikasjoner

- Kronisk mellomørebetennelse med funksjonsnedsettelse av ossikkelkjeden
- Traumatisk skade på ossikkelkjeden
- Medfødte misdannelser i mellomøre

- Revisjonskirurgi på grunn av utilstrekkelig hørselsforbedring (f.eks. på grunn av migrasjon av en tidligere implantert protese)

7.3 Kontraindikasjoner

- Kjent følsomhet eller allergi mot titan
- Komplikasjoner eller følgetilstander av uløst mellomørebetennelse, som intrakraniell abscess, hjernehinnebetennelse, lateral sinustrombose, maligniteter eller pasientspesifikk systemisk sykdom
- Akutt mellomørebetennelse
- Nedsatt sårheling

7.4 Pasientmålgruppe

Produktet er egnet for bruk i følgende pasientgrupper:

- Barn og ungdommer
- Voksne
- Pasienter av alle kjønn

7.5 Tiltent bruker

Den tiltente brukeren er en lege med erfaring i behandling av lignende tilfeller med dette produktet eller med sammenlignbare produkter, eller en lege med følgende spesialfelt:

- ENT (otorinolaryngologi)

7.6 Forventet levetid

Tympanoplastikkprotese	Ingen produktspesifikke begrensninger. Regelmessige kontroller er nødvendige.
AC Sizer System Total	Engangsprodukt – levetiden tilsvarer prosedyrens varighet.
Tilbehør: Titanpinsett / Mikrosaks / Kuttetang / Mikrolukketang i titan/ Instrumentbrett (Tray TTP VARIAC)	Hyppig prosessering har liten innvirkning på disse instrumentene. Produktets levetid er vanligvis basert på slitasje samt skader fra bruk. Se prosesseringsinstruksjonene.

7.7 Tiltent brukssted

- Operasjonssal

Det er brukerens ansvar å beslutte i hvert enkelt tilfelle hvilke forholdsregler som må iverksettes for eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

8 Forventet klinisk nytte

I henhold til den kliniske evalueringen kan produktet brukes trygt og effektivt for behandling i henhold til de nevnte indikasjonene.

9 Mulige komplikasjoner og bivirkninger

- Implantatmigrasjon
- Implantatekstrudering
- Lateralisering av implantatet
- Sensornevral hørselstap
- Infeksjon
- Svimmelhet
- Periprostetiske fibroser
- Periprostetisk kolesteatomdannelse

10 Kombinasjon med andre prosedyrer

Tympanoplastikkproteser:

ADVARSEL

- Laserterapi, argonplasmakoagulasjon, høyfrekvent kirurgi og andre prosedyrer, hvis effekt skyldes varme: Ikke bruk de metodene direkte på produktet.
Ellers er skade på vevet og produktskade mulig.

- Bortsett fra de spesifikke bestemmelsene om MR-sikkerhet, gjelder følgende: Eksponer ikke produktet for diagnostisk eller terapeutisk elektromagnetisk stråling.
Ellers er det risiko for pasientens helse.
- Produktet er MR-betinget. Bruk produktet kun i MR-felt i henhold til spesifikasjonene.
Mulige konsekvenser ved bruk av produktet i MR-felt utenfor spesifikasjonene inkluderer: Oppvarming av produktet, elektrostatisk utladning, følgeskader forårsaket av maktbruk mot produktet, feil ved avbildning (også i omkringliggende vev)

For viktig informasjon om MR, se:

<http://www.kurzmed.com/de/mr-information.html>

11 Oppbevaringstid og lagring

For utløpsdato, se produktetiketten.

Oppbevar produktet i uåpnet originalforpakning.

Lagre produktet på et tørt sted og beskytt det mot sollys.

12 Prosessering

Tympanoplastikkprotese, AC-målersystem:

⚠ ADVARSEL

- Engangsprodukt: Ikke foreta prosessering (f.eks. rengjøring, desinfisering, sterilisering), resterilisering eller gjenbruk av produktet.
Dette er den eneste måten som sikrer at produktet er bakteriefritt og funksjonsdyktig. Som følge av produktets mekaniske egenskaper kan prosessering eller resterilisering føre til nedbrytning av materialet.

Instrumenter (titanpinsett, mikrosaks, klippetang, lukketang), instrumentbrett (brett TTP-VARIAC):

⚠ ADVARSEL

- Produktet er ikke sterilt. Prosesser produktet før første og videre bruk.
Dette er den eneste måten å sørge for at produktet er bakteriefritt og funksjonelt. Prosesser i henhold til prosesseringsinstruksjonsdokumentet. [▶ Tilleggsinformasjon, side 4]

13 Bruksinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk produktet hvis forpakningen eller produktet er skadet eller utløpt.
Dette er den eneste måten som sikrer at produktet er bakteriefritt og funksjonsdyktig.
- Ta produktet ut av lagringsemballasjen kun rett før bruk. Når produktet tas ut av emballasjen, må du følge relevante hygieneforskrifter.
Ellers er det risiko for pasientens helse.

MERKNAD

- Grip, transporter og manipuler alltid protesen med en passende sugEANordning eller med passende tang eller pinsett.
Hold alltid protesen i hodeplaten for griping og transport. Sørg for at proteseskiftet ikke deformeres utilsiktet eller at protesen ikke skades på noen annen måte.
Ellers kan protesens funksjon bli svekket.

Sørg for at påkrevde hygieniske / sterile forhold for inngrepet foreligger.

Det plasseres som en del av tympanoplastikk av typen III (ossikulær rekonstruksjon).

Utfør inngrepet under egnet visuelt tilsyn.

13.1 Nødvendig utstyr og materialer

Som vanlig for tympanoplastikk av typen III.

Systemtilbehør for TTP VARIAC System Total:

- AC Sizer System Total
- Titanpinsett
- Mikrosaks
- Kuttetang
- Mikrolukketang i titan
- Instrumentbrett (Tray TTP VARIAC)

Produsenten anbefaler å bruke følgende produkter:

- KURZ Precise Bruskknivsett (REF 8000 155)
- Brusk tang Schimanski Design (REF 8000 193)
- Bruskstansesett (REF 8000 200)

13.2 Forberedelse av pasienten


Som vanlig for tympanoplastikk av typen III.

13.3 Bestemme proteselengden

Velg alltid lengden på protesen i henhold til anatomiske og funksjonelle forhold for å oppnå et godt hørselsresultat og unngå komplikasjoner. Bruk av målerskiven

Ta hensyn til tykkelsen på transplantatet som dekker protesens hodeplate i denne prosessen.


Ved bruk av OMEGA CONNECTOR: Ta også hensyn til den funksjonelle lengden til OMEGA CONNECTOR (0,5 mm).

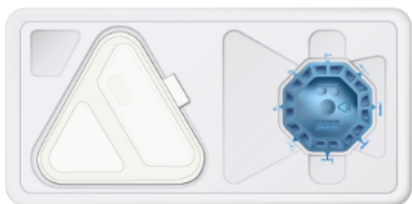

1. Åpne den sterile forpakningen og fjern målerskiven.




2. Hold den valgte måleren med et passende mikrokirurgisk instrument (f.eks. sugearbeid), og klipp med mikrosaks.

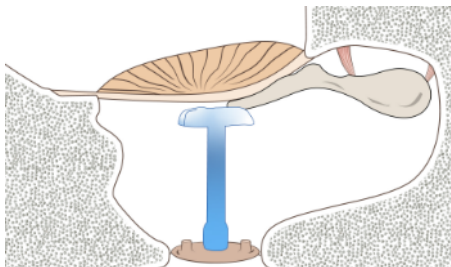


3. Plasser foten på måleren på stigbøylens fotplate.
OBS: Størrelsesspesifikasjonen tilsvarer den absolutte lengden på den respektive måleren.
Ta hensyn til tykkelsen på transplantatet når du bestemmer nødvendig lengde.
Ved bruk av OMEGA CONNECTOR: Ta også hensyn til den funksjonelle lengden til OMEGA CONNECTOR (0,5 mm).
4. Fjern måleren fra mellomøret etter bruk.

OBS: Målere brukes utelukkende til å bestemme nødvendig proteselengde og er ikke beregnet for implantasjon.

13.4 Pakke ut protesen

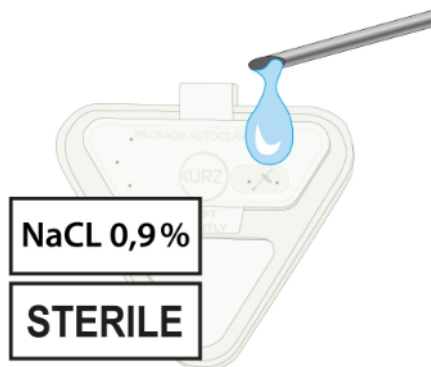

1. Påfør dråper med steril saltvannsløsning på åpningene i beskyttelsesemballasjen. Sørg for at perforeringene i lokket også er dekket av saltvannsløsning, slik at væske kan trenge inn i beskyttelsesemballasjen.

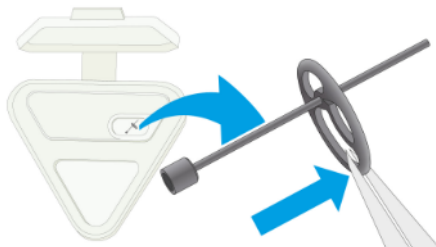


2. Fjern protesen forsiktig fra beskyttelsesemballasjen. OBS: Ikke grip protesen i skaftet for å unngå å bøye protesen.

13.5 Justere lengden på protesen




1. Velg fordypningen i målarskiven som samsvarer med riktig måler. Det er fordypninger mellom målerne i de respektive mellomstørrelsene.

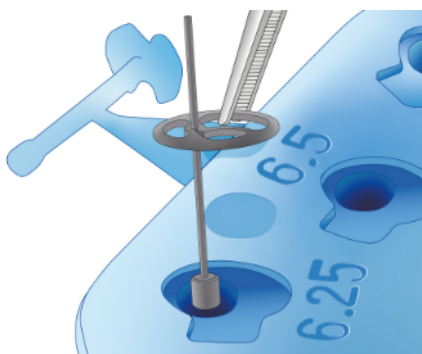


2. Sett protesen, foten først, inn i fordypningen så langt den går.



3. Skyv protesens hodeplate ned på protesens skaft til hodeplaten er helt satt inn og er i flukt med den tiltenkte fordypningen.

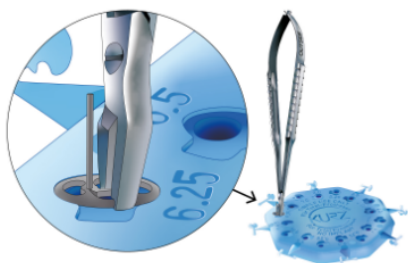

4. Bruk en lukketang til å lukke låsen på hodeplaten. For dette formålet posisjonerer du lemman på lukketangen merket UTENFOR i fordypningen på utsiden av hodeplaten. Posisjoner lemman på lukketangen merket INSIDE på innsiden av hodeplaten. Lukk forsiktig lukketangen helt. Dette retter ut braketten i hodeplaten og fikserer hodeplatens posisjon i forhold til skaftet.

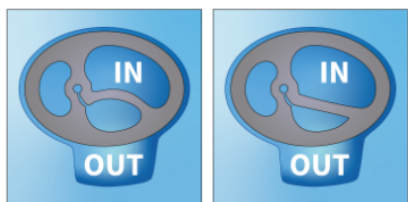



5. Bruk en skjæretang til å kutte av den utstikkende delen av skaftet.
OBS: Av tekniske årsaker er det ikke mulig å kutte skaftet slik at det er helt i flukt. Det gjenværende fremspringet bidrar til å stabilisere transplantatposisjonen. Ta hensyn til lengden på fremspringet når du velger transplantat.

13.6 Plassering av protesen

13.6.1 Plassering av protesen på stigbøylens fotplate

Ved bruk av OMEGA CONNECTOR: Følg også bruksanvisningen for OMEGA CONNECTOR.



1. Posisjoner protesestammen sentralt på stigbøylens fotplate.




2. Alternativt: Bruk en brusksko (bruskskive i en definert størrelse og form med sentralt hull) for å stabilisere protesens base. Bruk bruskstansen (REF 8000200) til å lage bruskskoen.
3. Juster protesen på stigbøylens fotplate.
OBS: Sørg for at protesen er godt plassert på stigbøylens fotplate.
4. Om nødvendig må du tilpasse protesens form nøye til de anatomiske strukturene. Bøy skaftet forsiktig for å gjøre dette.

Koble deretter protesens hodeplate til trommehinnen / malleushåndtaket.


13.6.2 Koble hodeplaten til trommehinnen / malleushåndtaket

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at protesens hodeplate ikke er i direkte kontakt med trommehinnen. Dekk hodeplaten på motsatt side for trommehinnen med et transplantat.
Ellers er det fare for perforering av trommehinnen.

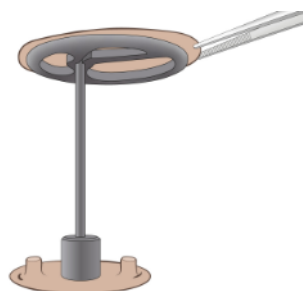

1. Plasser transplantatet (bruskskive, ca. 0,3–0,5 mm tykk) på protesens hodeplate. Sørg for at transplantatet dekker hodeplaten helt.

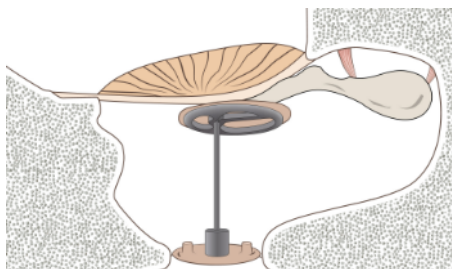

2. Koble protesens hodeplate til trommehinnen / med malleushåndtaket.

Kontroller deretter protesens passform.

13.6.3 Kontroller protesens passform

1. Kontroller om protesen forårsaker spenning i trommehinnen. Hvis dette er tilfelle: Fjern den implanterte protesen og erstatt den med en kortere protese.
2. Hvis protesen som brukes er for kort: Fjern den implanterte protesen og erstatt den med en lengre protese.
3. Steng tilgangen til mellomøret.

13.7 Fjerning av protesen

Protesen er ment å forbli i kroppen. Skulle det likevel være nødvendig å fjerne protesen:

Før du fjerner protesen: Løsne eventuelle sammenvoksninger.

Oppfølgingsbehandling etter behandlende leges skjønn.

14 Etterbehandling

- Etterbehandlinger som indikert av den behandlende legen.

15 Instruksjoner til pasienten

Pasientinstruksjonen må omfatte:

⚠ ADVARSEL

- Beskytt den ytre øregangen mot vanninntregning.
Ellers foreligger det en risiko for betennelse / infeksjon i mellomøret.
- Unngå alvorlige svingninger i omgivelsestrykket (f.eks. stuping, hopping med hodet først i vann, eksplosjoner).
Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på trommehinnen / beinene, noe som kan føre til hørsels- og balanseforstyrrelser.


OBS: Informer også pasienten om konsekvensene av å kombinere med andre prosedyrer.

[▶ Kombinasjon med andre prosedyrer, side 7]

Implantatkort: [▶ Implantatkort, side 12]

16 Implantatkort

OBS: Fyll ut implantatkortet før pasienten skrives ut fra sykehus og gi det til pasienten.

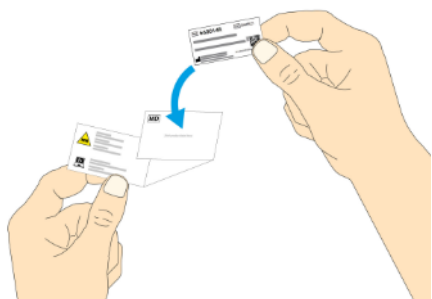

1. Fest én av de medfølgende produktetikettene i den angitte boksen på implantatkortet. Fyll ut alle andre avsnitt.

Implantatkortet må fremvises ved hver radiologisk undersøkelse.

17 Avfallshåndtering

⚠ ADVARSEL

- Produktet var i kontakt med potensielt smittefarlige substanser av menneskelig opprinnelse. Rengjør / pakk produktet for deponering i henhold til den konkrete risikoen for kontaminering. Avhend produktet i samsvar med prosedyrene for farlig avfall på sykehus.
Ellers er det risiko for infeksjon for brukeren og tredjeparter.

Avfallshåndteringen må foretas i henhold til nasjonale bestemmelser på området og ut fra den korresponderende risikoklassen.

18 Garanti

Produktets materiale og design er garantert på forsendelsestidspunktet. Produsenten kjenner verken pasientens diagnose eller bruksområdet, og har ingen innflytelse på forholdene produktet brukes under. Lagringsforholdene etter levering av produktet er også utenfor produsentens ansvarsområde.

På grunn av biologiske og individuelle forskjeller er ingen produkter 100 % effektive under alle omstendigheter.

Produsenten kan derfor ikke garantere en positiv effekt eller fravær av negative effekter ved produktbruk. Det medisinske personalet må bruke produktet basert på deres medisinske utdanning og erfaring, og de er ansvarlige for korrekt bruk.

Garantien (reparasjon eller utskifting) gjelder kun hvis produktet brukes i samsvar med denne bruksanvisningen (for instrumenter, spesielt med hensyn til håndtering, rengjøring, sterilisering og vedlikehold); garantiperioden starter på leveringsdatoen.

Hvis du har grunn til å tro at et nytt produkt er defekt, kan du kontakte kundeservice skriftlig umiddelbart og gi en så detaljert beskrivelse som mulig av feilen, REF (artikkelnummer) og LOT (batchkode) og / eller serienummer. Alle angivelig defekte produkter må returneres til oss for inspeksjon. Instrumenter må være fullstendig rengjort og sterilisert, og relevant dokumentasjon må vedlegges returen.

Hvis produsenten finner at produktet til tross for all tilbørlig forsiktighet var defekt på leveringstidspunktet, vil han reparere produktet eller erstatte det omgående. Hvis reparasjon eller erstatning av produktet ikke er mulig, har kjøperen rett til å heve kjøpet eller redusere betalingen, men med maksimalt kjøpesummen.


Ytterligere krav eller krav som ikke er nevnt her på grunn av defekt, og andre krav uavhengig av juridisk grunn, inkludert krav basert på ulovlige handlinger og om erstatning for immaterielle skader mot produsenten, hans agenter, forhandlere og leverandører, er utelukket med mindre gjeldende lov er i strid med ansvarsfraskrivelsen, f.eks. i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet eller i tilfelle fysisk skade.

Alle krav basert på konsekvensene av manglende overholdelse av bruksanvisningen, inkludert spesifiserte indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, instruksjoner, bruk, lagring og bruk utenfor merkelappen, samt konsekvensene av en kombinasjon med tredjepartsprodukter, er utelukket.

Videre er alle krav som følge av bruk av produkter som er utløpt, eller som ble brukt til tross for åpenbar skade på emballasjen, eller som ble resterilisert og / eller resirkulert i strid med bruksanvisningen, utelukket.

Ingen har lov til å endre ovennevnte betingelser, avgi ytterligere garanti- eller ansvarserklæringer, eller garantere egenskaper som overgår de som er spesifisert i bruksanvisningen.

19 Spesifikasjoner

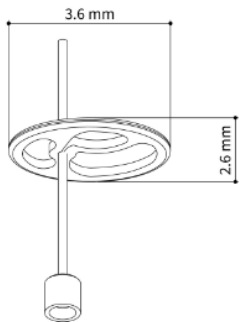TTP VARIAC System Total REF 1004020	Navn	Materiale	Egenskaper
	Tympanoplastikkprotese	Titan	Variabel lengde: Lengde 3,0– 7,0 mm Justerbar i trinn på 0,25 mm Kompatibel med OMEGA CONNECTOR (separat bruksanvisning)
	AC Sizer System Total	Plast	8 målere i forskjellige lengder (3.0/ 3.5/ 4.0/ 4.5/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 6.5 mm) 16 fordypninger for lengdejustering: 3,0–7,0 mm i trinn på 0,25 mm