

## Tympanoplastiekprothesen

Gedeeltelijke prothesen, variabele lengte

Accessoires



TTP®-VARIAC System Partial
































HEINZ KURZ GMBH  
TUEBINGER STR. 3  
72144 DUSSLINGEN  
GERMANY

## Inhoudsopgave

<b>1 Over dit document</b> .....	<b>3</b>	7.6	Verwachte levensduur .....	7
1.1 Symboolverklaring .....	3	7.7	Beoogde gebruikslocatie .....	8
1.2 Veiligheidsmarkeringen .....	4	<b>8</b>	<b>Verwacht klinisch voordeel</b> .....	<b>8</b>
1.3 Aanvullende informatie .....	4	<b>9</b>	<b>Mogelijke complicaties en bijwerkingen</b> .....	<b>8</b>
1.4 Veiligheidsgerelateerde wijzigingen .....	4	<b>10</b>	<b>Combineren met andere procedures</b> .....	<b>8</b>
<b>2 Belangrijke veiligheidsmaatregelen</b> .....	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>Houdbaarheid en opslag</b> .....	<b>8</b>
<b>3 Artikelnummers</b> .....	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>Herverwerking</b> .....	<b>8</b>
<b>4 Inhoud van de verpakking</b> .....	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>Gebruiksaanwijzingen</b> .....	<b>9</b>
<b>5 Verpakking en steriliteit</b> .....	<b>5</b>	13.1	Benodigde uitrusting en materialen .....	9
<b>6 Productbeschrijving</b> .....	<b>5</b>	13.2	Vorbereiding van de patiënt .....	9
6.1 Algemene informatie .....	5	13.3	De lengte van de prothese bepalen .....	9
6.2 Structuur en gebruik .....	5	13.4	De prothese uit de verpakking halen .....	10
6.3 Materialen die mogelijk in contact komen met de patiënt .....	6	13.5	De lengte van de prothese aanpassen .....	10
6.4 Accessoires .....	6	13.6	De prothese plaatsen .....	11
6.5 Andere hulpmiddelen die in combinatie met het hulpmiddel kunnen worden gebruikt .....	7	13.6.1	Het plaatsen van de prothese op de stapeskop .....	11
<b>7 Beoogd gebruik</b> .....	<b>7</b>	13.6.2	De kopplaat met het trommelvlies/de malleussteel verbinden .....	12
7.1 Gebruiksdoel .....	7	13.6.3	De pasvorm van de prothese controleren .....	12
7.2 Indicaties .....	7	13.7	De prothese verwijderen .....	12
7.3 Contra-indicaties .....	7	<b>14</b>	<b>Nazorg</b> .....	<b>12</b>
7.4 Patiëntendoelgroep .....	7	<b>15</b>	<b>Instructie voor de patiënt</b> .....	<b>12</b>
7.5 Beoogde gebruiker .....	7	<b>16</b>	<b>Verwijdering</b> .....	<b>13</b>
		<b>17</b>	<b>Specificaties</b> .....	<b>13</b>

## 1 Over dit document

### 1.1 Symboolverklaring

Symbool	Beschrijving
	Voorzichtig: Lees de gebruiksaanwijzing
	Voorzichtig!
	Breekbaar; voorzichtig behandelen
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
	Niet blootstellen aan direct zonlicht
	Droog houden
	Uiterlijke houdbaarheidsdatum
	Gesteriliseerd middels bestraling
	Niet hergebruiken
	Niet hersteriliseren
	Enkelvoudig steriel barrièresysteem
	Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende binnenverpakking
	Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende buitenverpakking
	MR-voorwaardelijk
	Medisch hulpmiddel
	Artikelnummer
	Batchcode
	Unieke hulpmiddelidentificatie (UDI)
	HIBC: Health Industry Barcode (barcode gezondheidszorg)
	Aantal stuks per verpakkingseenheid
	Producent
	Fabricagedatum
	(VS) Let op: Volgens de federale wetgeving mag dit artikel alleen door of in opdracht van een arts verkocht worden.
	Lees de gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing voor dit product is in elektronische vorm beschikbaar (e-labeling).
	Naam patiënt
	Implantatiedatum
	Naam van de implanterende instelling / zorgverlener
	Website met patiënteninformatie
	Grüner Punkt: Dubbel recyclingsysteem in Duitsland

Tab. 1: Beschrijving van de gebruikte symbolen

## 1.2 Veiligheidsmarkeringen

### WAARSCHUWING

Als deze niet in acht worden genomen, heeft dit mogelijk zware verwondingen, ernstige gevolgen voor de algehele gezondheid of de dood van de patiënt, gebruiker of een derde partij tot gevolg.

### AANWIJZING

Productschade of andere schade kan optreden als de aanwijzingen niet worden nageleefd.

## 1.3 Aanvullende informatie

Downloadkoppeling voor deze gebruiksaanwijzing: <sup>1)</sup>	<a href="http://www.kurzmed.com/en/ifu/tym5.html">www.kurzmed.com/en/ifu/tym5.html</a>
Downloadkoppeling voor het informatiedocument voor patiënten: <sup>1)</sup>	<a href="http://www.kurzmed.com/en/pi/tym.html">www.kurzmed.com/en/pi/tym.html</a>
Samenvatting van de veiligheids- en klinische prestaties (SSCP): <sup>1)</sup>	<a href="https://ec.europa.eu/tools/eudamed">https://ec.europa.eu/tools/eudamed</a> Om naar de productspecifieke SSCP te zoeken, voert u de basis-UDI-DI van het product in.
Basis UDI-DI (hulpmiddelidentificatie):	++EHKM0017D
Disclaimer voor de beschikbaarheid van de SSCP	In het algemeen geldt: De SSCP wordt pas beschikbaar nadat het product is geautoriseerd in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2017/745 (verordening betreffende medische hulpmiddelen). De hier beschreven implementatie is niet van toepassing tot het moment van inwerkingtreding van de overeenkomstige module van de Eudamed-databank. Tot dat moment is de SSCP beschikbaar via de volgende downloadkoppeling: <a href="http://www.kurzmed.com/en/sscp/tym.html">www.kurzmed.com/en/sscp/tym.html</a>
Internationale adressen:	<a href="https://www.kurzmed.com/en/contact.html">https://www.kurzmed.com/en/contact.html</a>

<sup>1)</sup>Wordt doorlopend bijgewerkt.

## 1.4 Veiligheidsgerelateerde wijzigingen

Documentnummer	Datum van uitgave	Wijzigingen
0005956_01	2024-10	Volledige revisie

## 2 Belangrijke veiligheidsmaatregelen

### WAARSCHUWING

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Volg de gebruiksaanwijzing en bewaar deze. Anders heeft dit risico's voor de gezondheid van de patiënt tot gevolg.
- Het product mag niet worden gedemonteerd of gemodificeerd. Anders heeft dit risico's voor de gezondheid van de patiënt tot gevolg.

LET OP: Als er een ernstig incident heeft plaatsgevonden dat is gerelateerd aan het apparaat, moet het incident worden gerapporteerd aan de producent en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt woont.

## 3 Artikelnummers

[ ► Specificaties, Pagina 13 ]

## 4 Inhoud van de verpakking

TTP-VARIAC System Partial (Tympanoplastiekprothese + AC Sizer System Partial)	1 x tympanoplastiekprothese 1 x Sizer disk 1 x implantaatkaart 4 x productlabel
---	--


Accessoires: Titanium pincet/Microschaar/Knip- tang/Titanium Micro Closing For- ceps/Instrumententray (Tray TTP- VARIAC)	1 x instrument/instrumententray (Tray TTP-VARIAC) 1 x herverwerkingsinstructies
--	--

## 5 Verpakking en steriliteit

TTP-VARIAC System Partial (Tympanoplastiekprothese + AC Sizer System Partial)	Het product is steriel (gesteriliseerd met behulp van straling). Verpakking: Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende binnenverpak- king (prothese in een plastic driehoekige doos en een harde blisterverpakking) + bui- tenverpakking (vouwdoos)
Accessoires: Titanium pincet/Microschaar/Knip- tang/Titanium Micro Closing For- ceps/ Instrumententray (Tray TTP- VARIAC)	Dit product is niet steriel. Verpakking: Zakje met ziplock + buitenverpakking (vouwdoos); Instrumententray: Alleen zakken met kliksluiting


## 6 Productbeschrijving

### 6.1 Algemene informatie

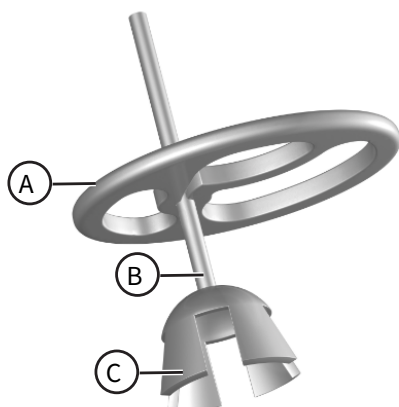

Afb. 1: Tympanoplastiekprothese

- A Gefenestreeerde kopplaat met vergrendelmechanisme
- B Schacht met variabele lengte
- C Voet van prothese: Expandeerbare klok met 4 sleuven (2 bredere sleuven voor positionering op de crura van de stapes en de stapediusspees)

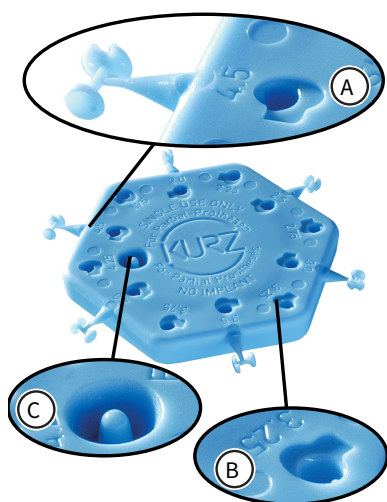

Afb. 2: AC Sizer System Partial

[ ▶ Specificaties, Pagina 13 ]

Accessoires: [ ▶ Accessoires, Pagina 6 ]

### 6.2 Structuur en gebruik

Tympanoplastiekprothese	Prothesen die worden ingebracht om middenoorstructuren die betrokken zijn bij de geleiding van geluid geheel of gedeeltelijk te vervangen.
-------------------------	--

AC Sizer System Partial	Set afneembare dummyprothesen gemonteerd op een schijf, elk in maat overeenkomend met een van de beschikbare tympanoplastiekprothesen. De dummyprothesen worden gebruikt om de benodigde maat van de tympanoplastiekprothese te bepalen. De schijf wordt gebruikt om de lengte van KURZ TTP-VARIAC gedeeltelijke/totale prothesen aan te passen voor het inbrengen.
-------------------------	---

### 6.3 Materialen die mogelijk in contact komen met de patiënt

In de onderstaande tabel staan alle implantaatmaterialen waarmee de gebruiker of patiënt in contact kan komen tijdens het gebruik.

Product (onderdeel)	Materiaal	Contactpersoon
Tympanoplastiekprothese	100% titanium	Patiënt

AC Sizer System Partial: [ ▶ Specificaties, Pagina 13 ]






Niet van natuurrubber gemaakt.

Tijdens het productieproces worden geen producten gebruikt die van natuurrubber zijn gemaakt.

LET OP: Gebruik het product niet als de patiënt bekende overgevoeligheden/allergieën heeft voor de te gebruiken materialen.

### 6.4 Accessoires

Systeemaccessoires voor TTP-VARIAC System Partial:

Accessoires	Afbeelding	Artikelnummer	Materiaal	Beoogd gebruik
Titanium pincet		8000136	Titanium	De titanium pincet is een passief, herbruikbaar hulpmiddel dat intraoperatief en niet-invasief gebruikt wordt tijdens een tympanoplastiekprocedure om de KURZ tympanoplastiekprothesen te hanteren.
Microschaar		8000172	Roestvrij staal	De microschaar is een passief, herbruikbaar hulpmiddel dat intraoperatief en niet-invasief wordt gebruikt om de sizer uit de AC Sizer System Total/gedeeltelijk te knippen.
Titanium Micro Closing Forceps		800137	Titanium	De Titanium Micro Closing Forceps is een passief, herbruikbaar hulpmiddel dat intraoperatief en niet-invasief wordt gebruikt om de kopplaat van een KURZ TTP VARIAC prothese op de schacht te bevestigen nadat de lengte is aangepast.
Kniptang		8000171	Roestvrij staal	De kniptang is een passief, herbruikbaar hulpmiddel dat intraoperatief en niet-invasief wordt gebruikt om het uitstekende deel van de schacht van een KURZ TTP VARIAC-prothese af te knippen nadat de lengte is aangepast en de kopplaat is vastgezet.
Instrumenten-tray (Tray TTP-VARIAC)		8000173	Roestvrij staal	De Tray TTP-VARIAC-set is een herbruikbaar hulpmiddel dat wordt gebruikt om de KURZ VARIAC-instrumentenset in te bewaren tijdens transport, sterilisatie en opslag.

Andere accessoires (afzonderlijke gebruiksaanwijzing):

- KURZ Precise Kraakbeenmessenset (REF 8000 155)

- Kraakbeentang Schimanski-ontwerp (REF 8000 193)

### 6.5 Andere hulpmiddelen die in combinatie met het hulpmiddel kunnen worden gebruikt

Met uitzondering van de apparatuur en materialen die nodig zijn voor implantatie, is het product niet bedoeld om samen met andere producten te worden gebruikt.

## 7 Beoogd gebruik

### 7.1 Gebruiksdoel

Tympanoplastiekprothese	KURZ-middenoorprothesen zijn bedoeld voor de gedeeltelijke of volledige chirurgische vervanging van de ossiculare keten van het menselijk middenoor. Het doel is het herstel van de mechanische overdracht van geluid van het trommelvlies naar het ovale venster van het slakkenhuis met zo min mogelijk aantasting van het gehoor.
AC Sizer System Partial	De AC Sizer System Partial is een passief, steriel hulpmiddel voor eenmalig gebruik. De sizer wordt gebruikt voor intraoperatieve en chirurgisch invasieve bepaling van de lengte van de KURZ gedeeltelijke tympanoplastiekprothesen door de sizer tijdelijk in de implantatieplaats te plaatsen. De AC Sizer System Partial is voorzien van een kegel voor het expanderen van het klokvormige uiteinde van de KURZ gedeeltelijke prothesen vóór implantatie. De AC Sizer System Partial wordt gebruikt voor niet-invasieve aanpassing van gedeeltelijke prothesen van het KURZ TTP-VARIAC-systeem vóór implantatie.

Accessoires: [ ▶ Accessoires, Pagina 6 ]

### 7.2 Indicaties

- Chronische otitis media met functionele beschadiging van de ossiculare keten
- Traumatisch letsel aan de ossiculare keten
- Aangeboren afwijkingen van het middenoor
- Revisiechirurgie vanwege onvoldoende gehoorverbetering (bijv. door dislocatie van een eerder geïmplanteerde prothese)

### 7.3 Contra-indicaties

- Bekende overgevoeligheid of allergie voor titanium
- Complicaties of restverschijnselen van niet opgeloste otitis media, zoals een intracranieel abces, meningitis, trombose van de sinus lateralis, maligniteiten of patiëntspecifieke systemische aandoeningen
- Acute middenoorontsteking
- Slechte wondgenezing

### 7.4 Patiëntendoelgroep

Het product is geschikt voor gebruik bij de volgende patiëntengroepen:

- Kinderen en jongeren
- Volwassenen
- Patiënten van alle genders

### 7.5 Beoogde gebruiker

De beoogde gebruiker is een arts die ervaring heeft met de behandeling van soortgelijke gevallen met dit product of met vergelijkbare producten, of een arts met de volgende specialisatie:

- ENT (otorinolaryngologie)

### 7.6 Verwachte levensduur

Tympanoplastiekprothese	Geen productspecifieke beperkingen. Regelmatige controle-onderzoeken zijn noodzakelijk.
AC Sizer System Partial	Product voor eenmalig gebruik – de levensduur komt overeen met de duur van de procedure.
Accessoires: Titanium pincet / Microschaar / Kniptang / Titanium Micro Closing	Regelmatige herverwerking heeft weinig invloed op deze instrumenten. Het einde van de levensduur van een product wordt gewoonlijk gebaseerd op slijtage en schade door gebruik. Raadpleeg de instructies voor herverwerking.

### 7.7 Beoogde gebruikslocatie

- Operatiekamer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om per geval te bepalen welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen voor complicaties die kunnen optreden.

### 8 Verwacht klinisch voordeel

Volgens de klinische evaluatie kan het product veilig en effectief worden gebruikt voor de behandeling op basis van de vermelde indicaties.

### 9 Mogelijke complicaties en bijwerkingen

- Verschuiving van het implantaat
- Extrusie van het implantaat
- Lateralisatie van het implantaat
- Sensorineuraal gehoorverlies
- Infectie
- Duizeligheid
- Periprothetische fibrose
- Periprothetische cholesteatoomvorming

### 10 Combineren met andere procedures

Tympanoplastiekprothesen:

#### WAARSCHUWING

- Laserbehandeling, behandeling met argonplasma, hoogfrequente chirurgie en andere procedures waarvan het effect het gevolg is van warmte: Pas deze methodes niet direct op het product toe. Dit kan namelijk leiden tot weefsel- en productschade.
- Stel de patiënt niet bloot aan microgolfstraling. Anders ontstaan er risico's voor de gezondheid van de patiënt.
- Het product is in beperkte mate MRI-bestendig. Het product mag uitsluitend conform de specificaties in MRI-omgevingen worden gebruikt. De mogelijke gevolgen van het niet in overeenstemming met de specificaties gebruiken van het product in MRI-omgevingen zijn onder andere: Opwarming van het product, elektromagnetische ontladingen, gevolgschade door krachthinwerking op het product, verstoring van de beelden (ook in omliggend weefsel).

Belangrijke informatie over MRI vindt u op:

<http://www.kurzmed.com/de/mr-information.html>

### 11 Houdbaarheid en opslag

Zie productlabel voor de houdbaarheidsdatum.

Product bewaren in ongeopende originele verpakking.

Bewaar het product op een droge plaats en bescherm het tegen zonlicht.

### 12 Herverwerking

Tympanoplastiekprothesen, AC sizer-systeem:

#### WAARSCHUWING

- Product voor eenmalig gebruik: Product niet herverwerken (bijv. reinigen, desinfecteren, steriliseren), hersteriliseren of hergebruiken. Alleen zo kunnen asepsis en de werking van het product worden gegarandeerd. Vanwege de mechanische eigenschappen van het product, kunnen herverwerking of hersterilisatie leiden tot degradatie van het materiaal.

Instrumenten (titanium pincet, microschaar, kniptang, sluittang), instrumententray (Tray TTP-VARIAC):



## ⚠ WAARSCHUWING

- Dit product is niet steriel. Het product dient te worden herverwerkt vóór het eerste en elk volgende gebruik. Alleen zo kunnen asepsis en de werking van het product worden gegarandeerd. Voer de herverwerking uit in overeenstemming met de herverwerkingsinstructies.

### 13 Gebruiksaanwijzingen

## ⚠ WAARSCHUWING

- Product niet gebruiken als de verpakking of het product is beschadigd, of de houdbaarheidsdatum is overschreden. Alleen zo kunnen asepsis en de werking van het product worden gegarandeerd.
- Haal het product pas kort voor gebruik uit de bewaarverpakking. Zodra het product uit de verpakking is gehaald, moeten de relevante hygiënevoorschriften in acht worden genomen. Anders ontstaan er risico's voor de gezondheid van de patiënt.

## AANWIJZING

- Pak de prothese altijd vast, verplaats en manipuleer deze met een geschikt afzuigapparaat of met een geschikte tang of pincet. Houd de prothese altijd bij de kopplaat vast om deze vast te pakken en te verplaatsen. Zorg ervoor dat de schacht van de prothese niet per ongeluk vervormd wordt en dat de prothese niet op een andere manier beschadigd raakt. Anders functioneert de prothese mogelijk niet naar behoren.

Houd de hygiënische / steriele vereisten die voor de ingreep noodzakelijk zijn, in stand.

Het wordt ingebracht als onderdeel van een type III tympanoplastiek (ossiculaire reconstructie).

Voer de ingreep uit onder passende visuele supervisie.

#### 13.1 Benodigde uitrusting en materialen

Net als bij een type III tympanoplastiek.

Systeemaccessoires voor TTP-VARIAC System Partial:

- AC Sizer System Partial
- Titanium pincet
- Microschaar
- Kniptang
- Titanium Micro Closing Forceps
- Instrumententray (Tray TTP-VARIAC)

De producent raadt aan om de volgende producten te gebruiken:

- KURZ Precise Kraakbeenmessenset (REF 8000 155)
- Kraakbeentang Schimanski-ontwerp (REF 8000 193)

#### 13.2 Voorbereiding van de patiënt

Net als bij een type III tympanoplastiek.

#### 13.3 De lengte van de prothese bepalen

Kies de lengte van de prothese altijd in overeenstemming met de anatomische en functionele omstandigheden om een goed hoorresultaat te bereiken en complicaties te voorkomen. De sizer disk gebruiken


Houd hierbij rekening met de dikte van de graft om de kopplaat van de prothese te bedekken.



1. Open de steriele verpakking en haal de sizer disk eruit.




2. Houd de geselecteerde sizer vast met een geschikt microchirurgisch instrument (bijv. een afzuigapparaat) en knip af met een microschaar.

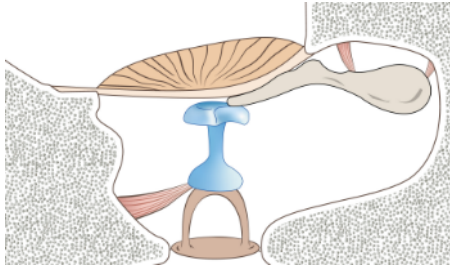


3. Plaats de klokvormige basis van de sizer op de stapeskop.  
LET OP: De maatspecificatie komt overeen met de absolute lengte van de desbetreffende sizer en de bijbehorende prothese.  
Houd bij het bepalen van de benodigde lengte rekening met de dikte van de graft die wordt gebruikt om de kopplaat te bedekken.
4. Verwijder de sizer na gebruik uit het middenoor.

LET OP: Sizers worden uitsluitend gebruikt om de benodigde protheselengte te bepalen en zijn niet bedoeld voor implantatie.

#### 13.4 De prothese uit de verpakking halen

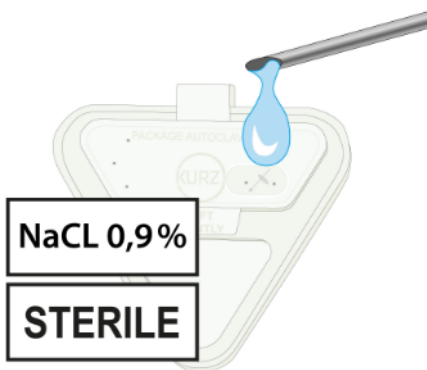

1. Breng druppels steriele zoutoplossing aan in de openingen van de beschermende verpakking. Zorg er hierbij voor dat de perforaties in het deksel ook bedekt zijn met zoutoplossing, zodat de vloeistof door de beschermende verpakking kan dringen.

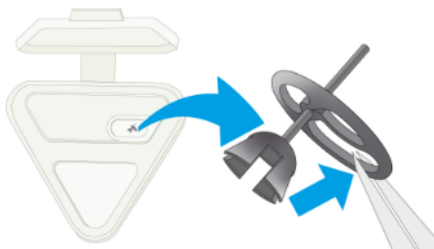


2. Verwijder de prothese voorzichtig uit de beschermende verpakking. LET OP: Pak de prothese niet vast bij de schacht om buigen van de prothese te voorkomen.


#### 13.5 De lengte van de prothese aanpassen




1. Kies de uitsparing in de sizer disk die overeenkomt met de juiste sizer. Er zijn uitsparingen tussen de sizers van de desbetreffende tussenmaten.

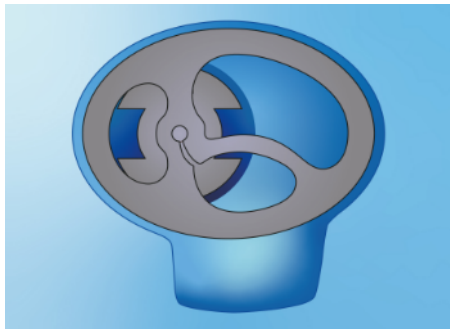


2. Gebruik de titanium pincet om de prothese zo aan te passen dat de twee bredere gleuven in de voet van de prothese naar de rand en het midden van de sizer disk wijzen en de twee smallere gleuven elk naar de zijkanten wijzen.

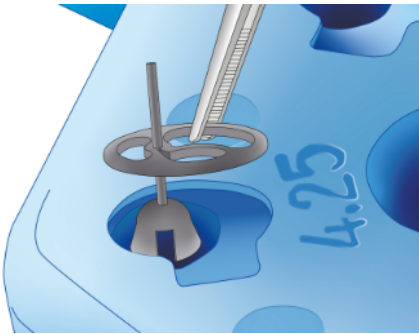


3. Plaats de prothese in deze richting, voet eerst, in de uitsparing totdat deze niet verder kan. De prothese glijdt in de uitsparing op de geleiderails.

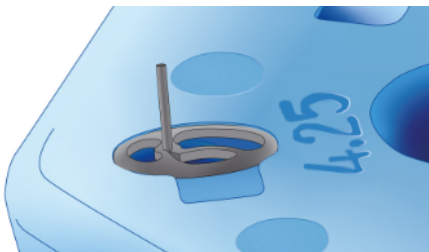

4. Schuif de kopplaat van de prothese op de schacht van de prothese naar beneden totdat de kopplaat volledig is ingebracht en vlak af ligt met de beoogde uitsparing.

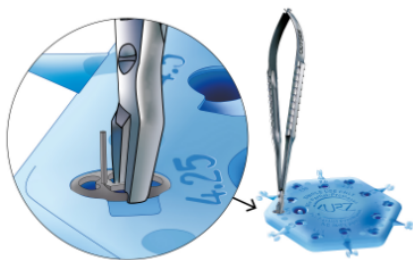

5. Gebruik een sluittang om de kopplaatvergrendeling te sluiten. Plaats hiervoor de poot van de sluittang met de markering OUTSIDE in de uitsparing aan de buitenkant van de kopplaat. Plaats de poot van de sluittang met de markering INSIDE in de uitsparing aan de binnenkant van de kopplaat. Sluit de sluittang voorzichtig en volledig. Hierdoor wordt de beugel in de kopplaat rechtgezet en wordt de positie van de kopplaat ten opzichte van de schacht gefixeerd.

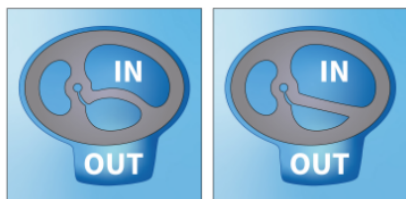


6. Gebruik een kniptang om het uitstekende deel van de schacht af te knippen. LET OP: Om technische redenen is het niet mogelijk om de schacht volledig gelijk met het oppervlak af te snijden. Het resterende uitstekende deel helpt om de positie van de graft te stabiliseren. Houd rekening met de lengte van het uitstekende gedeelte bij het kiezen van de graft.

## 13.6 De prothese plaatsen

### 13.6.1 Het plaatsen van de prothese op de stapeskop

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de twee bredere sleuven van de voet van de prothese bij de crura van de stapes worden geplaatst. Dit kan anders leiden tot necrose/verschuiving van de prothese.

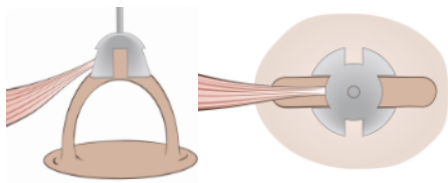

1. Plaats de prothese op de stapeskop. Plaats hiervoor de prothese zodanig dat de poten van de stapes zich elk in een van de brede sleuven bevinden. De stapediuspees loopt ook in een van de brede sleuven.  
Indien nodig: Expandeer de klok van de prothese met behulp van de sizer disk. Druk hiervoor de klok van de prothese voorzichtig op de kegel van de sizer disk met een geschikt chirurgisch instrument.

2. Positioneer de prothese op de stapeskop.

LET OP: Zorg ervoor dat de prothese stevig op de stapeskop zit.


3. Pas indien nodig de vorm van de prothese zorgvuldig aan de anatomische structuren aan. Buig hiervoor de schacht voorzichtig.

Verbind vervolgens de kopplaat van de prothese met het trommelvlies/de malleussteel.


### 13.6.2 De kopplaat met het trommelvlies/de malleussteel verbinden

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de kopplaat van de prothese niet in direct contact komt met het trommelvlies. Bedek de kopplaat tegenover het trommelvlies met een graft.
- Anders bestaat er een risico op perforatie van het trommelvlies.

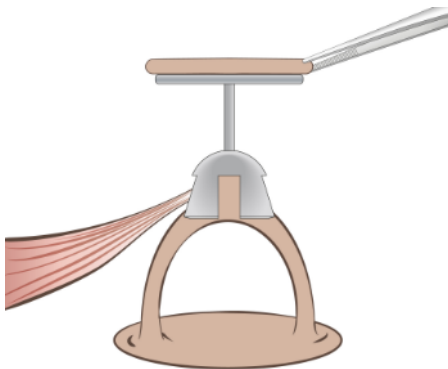

1. Plaats de graft (kraakbeenschijf, ongeveer 0,3 - 0,5 mm dik) op de kopplaat van de prothese. Zorg ervoor dat de graft de kopplaat volledig bedekt.

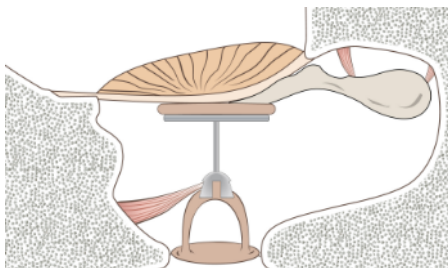

2. Verbind de kopplaat van de prothese met het trommelvlies/de malleussteel.

Controleer vervolgens de pasvorm van de prothese.

### 13.6.3 De pasvorm van de prothese controleren

1. Controleer of de prothese spanning veroorzaakt op het trommelvlies. Als dit het geval is: Verwijder de geïmplanteerde prothese en vervang deze door een kortere prothese.
2. Als de gebruikte prothese te kort is: Verwijder de geïmplanteerde prothese en vervang deze door een langere prothese.
3. Sluit de toegang tot het middenoor.

### 13.7 De prothese verwijderen

De prothese is bedoeld om in het lichaam te blijven. Mocht het echter toch nodig zijn om de prothese te verwijderen:

Voordat u de prothese verwijdert: Maak de hechtingen los.

Nazorg wordt door de behandelend arts bepaald.

## 14 Nazorg

- Controle-onderzoeken vinden plaats in overeenstemming met beoordeling door de behandelend arts

## 15 Instructie voor de patiënt

De instructies voor de patiënt moeten er als volgt uitzien:

## ⚠ WAARSCHUWING

- Bescherm de gehoorgang tegen het binnendringen van water.  
Anders kan dit leiden tot ontsteking/infectie van de tympanische holte.
- Vermijd sterke schommelingen in de omgevingsdruk (bijv. duiken, in het water duiken met het hoofd eerst, explosies).  
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel aan het trommelvlies/de oorschelpen, wat kan leiden tot gehoor- en evenwichtsstoornissen.

**BELANGRIJK:** Informeer de patiënt ook over de gevolgen van combineren met andere procedures.

[ ▶ Combineren met andere procedures, Pagina 8 ]

### Implantaatkaart

LET OP: Vul de implantaatkaart in en geef deze aan de patiënt.

Plak een van de productetiketten in het daarvoor bestemde vakje op de implantaatkaart. Vul alle andere vakken in.

De implantaatkaart moet worden getoond bij elk radiologische onderzoek.



## 16 Verwijdering

### ⚠ WAARSCHUWING

- Het product is in contact geweest met mogelijk infectueuze stoffen van menselijke oorsprong. Reinig / verpak het product voor het verwijderen, conform het specifieke besmettingsgevaar.  
Anders bestaat er een risico van infectie voor de gebruiker en derden.

Verwijdering dient plaats te vinden conform de nationale richtlijnen voor verwijdering en de betreffende risicoklasse.

## 17 Specificaties

TTP-VARIAC System Partial REF 1002020	Naam	Materiaal	Afmetingen
	Tympanoplastiekprothese	Titanium	Variabele lengte: Totale lengte L: 1,75 - 4,50 mm Functionele lengte FL: 0,75 - 3,50 mm Aanpasbaar in stappen van 0,25 mm
	AC Sizer System Partial	Plastic	6 sizers (totale lengte 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5 mm) 12 uitsparingen voor het aanpassen van de lengte: Totale lengte 1,75 - 4,50 mm in stappen van 0,25 mm